



RECFRANCE
Innovier pour Libérer

NOTICE D'UTILISATION

SUPPORT SIÈGE

 **JABA T0-T1-T2**




SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016



SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation	p.3
Utilisation prévue	p.3
Restriction d'utilisation / précautions d'emploi mises en garde spéciales	p.3
Description produit	p.3-5
Montage/ réglages	p.6-10
Adjonctions	p.10-12
Entretien / stockage /mise au rebut	p.13
Garantie	p.13
Identification	p.14
Mentions légales	p.14

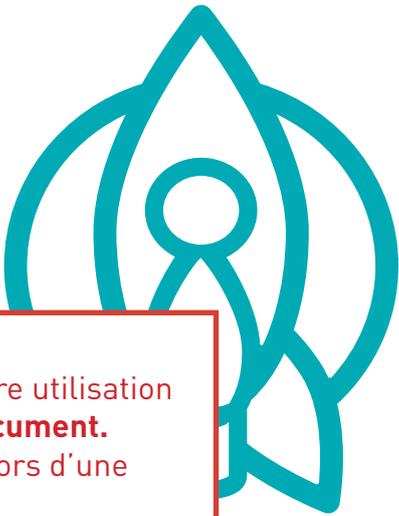

Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.** La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

UTILISATION PRÉVUE

Le Jaba est un support roulant d'intérieur. Il est équipé d'un vérin à action déportée qui lui permet de régler facilement la hauteur d'assise. L'inclinaison d'assise est également réglable avec une angulation de 30° vers l'arrière. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier. Le Jaba est prévu pour une utilisation exclusivement en intérieur.

RESTRICTION D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Jaba doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est conçu pour une utilisation en intérieur, sur un sol lisse et plat. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants.
- Les roulettes de l'appareil sont munies de frein; les utiliser dans les cas suivants: avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour monter et/ou incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.

 **Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.**

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante support de siège disponible en **3** tailles et plusieurs coloris.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Taille	Largeur	Longueur	Hauteur du plateau	Poids max. utilisateur
T0	520mm	770mm	180 à 470mm	15 kg
T1	550mm	800mm	300 à 500mm	25 kg
T2	600mm	850mm	300 à 500mm	60 kg

Les châssis Jaba peuvent accueillir des plateaux dont la largeur varie de 330 à 440mm, l'épaisseur de 12 à 25mm, et la profondeur jusqu'à 400mm.



MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.



N° article	Référence	Description	Qté
1	JA01	Ensemble support tablette	1
2	JA02	Canne de poussée	1
3	JA03	Ensemble segments jambier et repose-pieds	1

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

JA01	Ensemble support tablette petit modèle
JA01A	Ensemble support tablette grand modèle
JA02	Canne de poussée
JA03A	Ensemble segments jambier + repose pieds petit modèle
JA03B	Ensemble segments jambier + repose pieds grand modèle
JA03C	Ensemble segments jambier avec noix de serrage + repose pieds
JA05	Repose pied central angulaire
JA06	Levier d'aide à la montée d'assise
ABDU1	Fixation pour plot d'abduction
ABDU2	Fixation aimantée pour plot d'abduction
RR UNI X2	Roues roller unidirectionnelles (la paire, à l'arrière)
RR 2B X4	4 roues grand modèle Ø100mm avec frein
TB 001	Tablette largeur 560mm profondeur 500mm
TB002	Tablette largeur 680mm profondeur 600mm

CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi que les **vérins** sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.




MONTAGE/ RÉGLAGES

⚠ Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.

UTILISATION DES FREINS INTÉGRÉS AUX ROULETTES


⚠ Attention : Penser à verrouiller les freins avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour monter et/ou incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.

Appui sur la languette de la roulette pour actionner le frein (verrouillage en rotation de la roue et de la chape)




Appui sur la partie arrière de la languette pour déverrouiller le frein

POSITIONNEMENT DU PLATEAU D'ASSISE



INDEXAGE DU PLATEAU

Sur le plateau préalablement percé de 2 trous en $\text{Ø}6\text{mm}$, utiliser les doigts d'indexage pour l'empêcher de glisser.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PLATEAU


⚠ Attention : Le vérin est une aide à la montée. Sa force de poussée est fixe et les efforts à fournir par la personne manipulant le vérin peuvent varier en fonction du poids du patient. Immobilisez l'appareil grâce aux freins intégrés aux roulettes avant toute manipulation.

- JABA T0

Utiliser le levier de la poignée pour activer le vérin aidant à la montée et descente du plateau d'assise.



- JABA T1




- JABA T2




RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU PLATEAU

⚠ Attention : Immobilisez l'appareil grâce aux freins intégrés aux roulettes avant toute manipulation.


- JABA T0



- JABA T1




- JABA T2




ADJONCTIONS


SUPPORT TABLETTE




CANNE DE POUSSÉE



REPOSE-PIEDS



Insérer le levier d'aide à la montée d'assise
à l'arrière de la croix et serrer la molette.



ENTRETIEN / STOCKAGE / MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrissant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.



IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont – 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 – Fax : 04 67 95 06 94 – Mail : administration@recfrance.com
Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document : *NU_Jaba_071022-V4*

N° de lot :

Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement



MENTIONS LÉGALES

La conception générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire et tout autre élément composant le produit sont la propriété exclusive de RECFRANCE et/ou de ses fournisseurs.

Visuels non contractuels.

Tout incident grave survenu avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi.

DATE D'ACHAT : / /

CACHET DU REVENDEUR :



RECFRANCE
Innovater pour Libérer

136 ancienne route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél. : 04.67.95.04.50
Fax : 04.67.95.06.94

