RECFRANCE
Innover pour libérer

NOTICE D'UTILISATION

SUPPORT SIÈGE

WALLY

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

FABRIQUÉ EN FRANCE 19 95 RECFRANCE

SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation **p.3**

Utilisation prévue **p.3**

Restriction d'utilisation / précautions d'emploi

mises en garde spéciales **p.3**

Description produit **p.3-5**

Montage/ réglages **p.5-8**

Adjonctions **p.9**

Entretien / stockage /mise au rebut **p.10**

Garantie **p.10**

Identification **p.10**

Mentions légales **p.11**

Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.**
La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

UTILISATION PRÉVUE

Le Wally est un support roulant adaptable pour siège coque et mousse fraisée. Il dispose d'un vérin électrique pour aider au levage de charges lourdes: ce système est une solution idéale pour l'aidant avec un contrôle facile et précis. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier. Le Wally est prévu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

RESTRICTION D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Wally doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, sur des terrains non accidentés. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants.
- Le châssis est muni de freins de parking sur ses roues arrières; penser à les actionner avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour monter et/ou incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.

⚠ **Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.**

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante support de siège disponible en plusieurs coloris.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	Longueur	Hauteur du plateau	Inclinaison d'assise	Poids max. utilisateur
620mm	740mm	440 à 640mm	0° - 30° vers l'arrière	90 kg

Les châssis Wally peuvent accueillir des plateaux dont la largeur varie de 330 à 440mm, l'épaisseur de 12 à 25mm, et la profondeur jusqu'à 400mm.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.

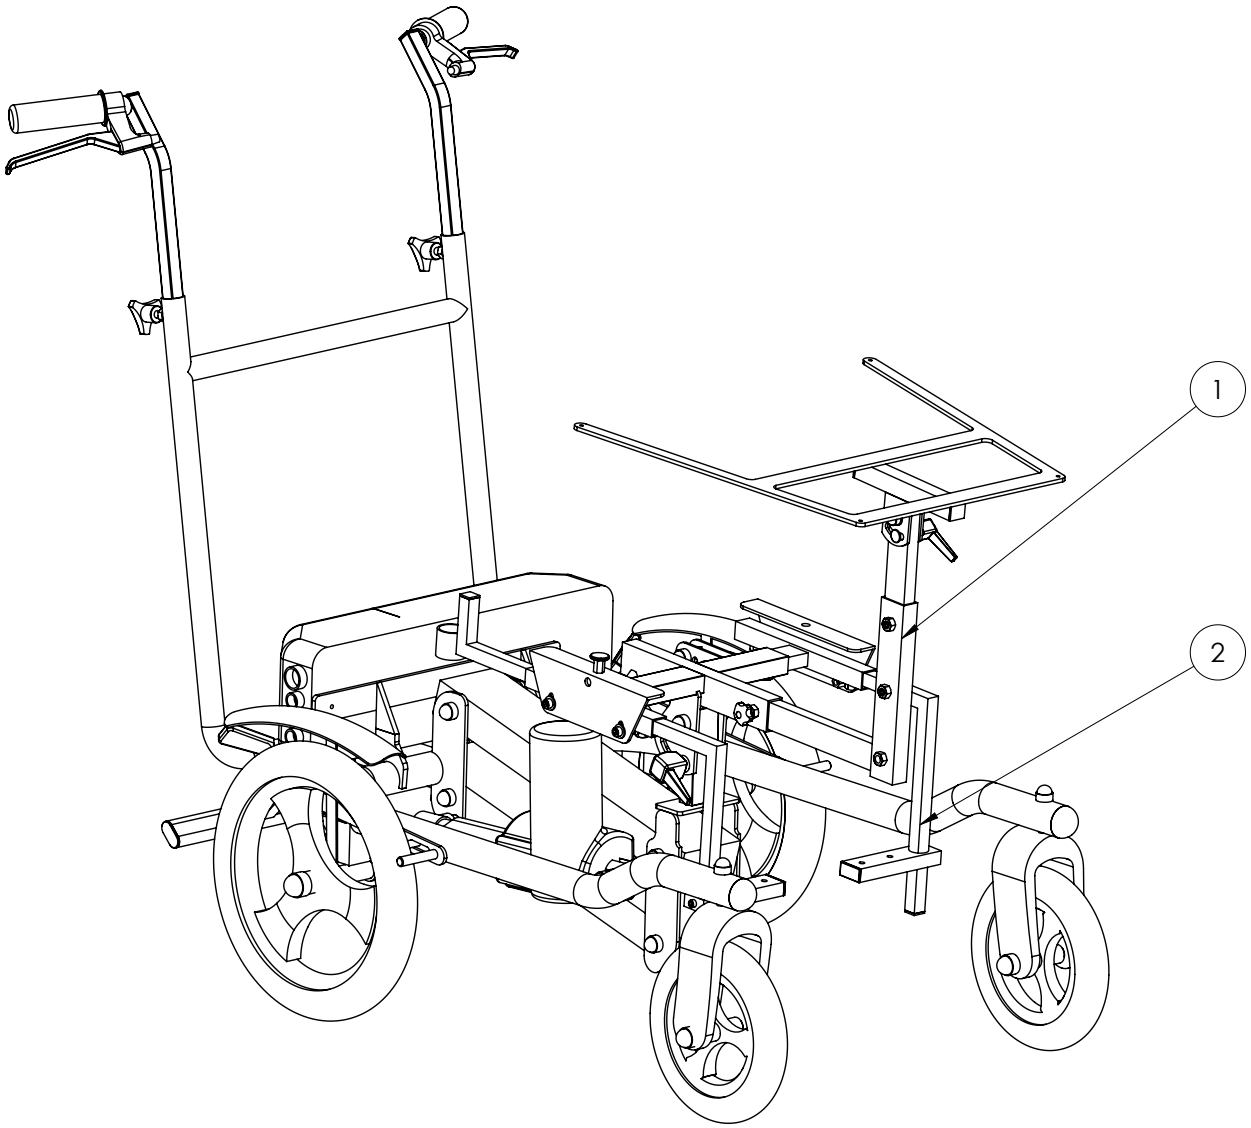

N° article	Référence	Description	Qté
1	WAL 01	Ensemble support tablette	1
3	WAL 03	Ensemble segments jambier et repose-pieds	1

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

WAL 01	Ensemble support tablette
WAL 03	Fixation repose-pieds (la paire) petit modèle
WAL 03B	Fixation repose-pieds (la paire) grand modèle
WAL 03C	Ensemble segments jambier inclinable
WAL 05	Repose-pieds central angulaire
ABDU1	Fixation pour plot d'abduction
ABDU2	Fixation aimantée pour plot d'abduction
TB 001	Tablette largeur 560mm profondeur 500mm
TB002	Tablette largeur 680mm profondeur 600mm
ST SIEGE	Support tablette pour siège

CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi que les **vérins** sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.

MONTAGE/ RÉGLAGES

⚠ **Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.**

FREINS DE PARKING ET GUIDON DE POUSSÉE

⚠ **Attention :** Penser à verrouiller les freins avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour monter et/ou incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.

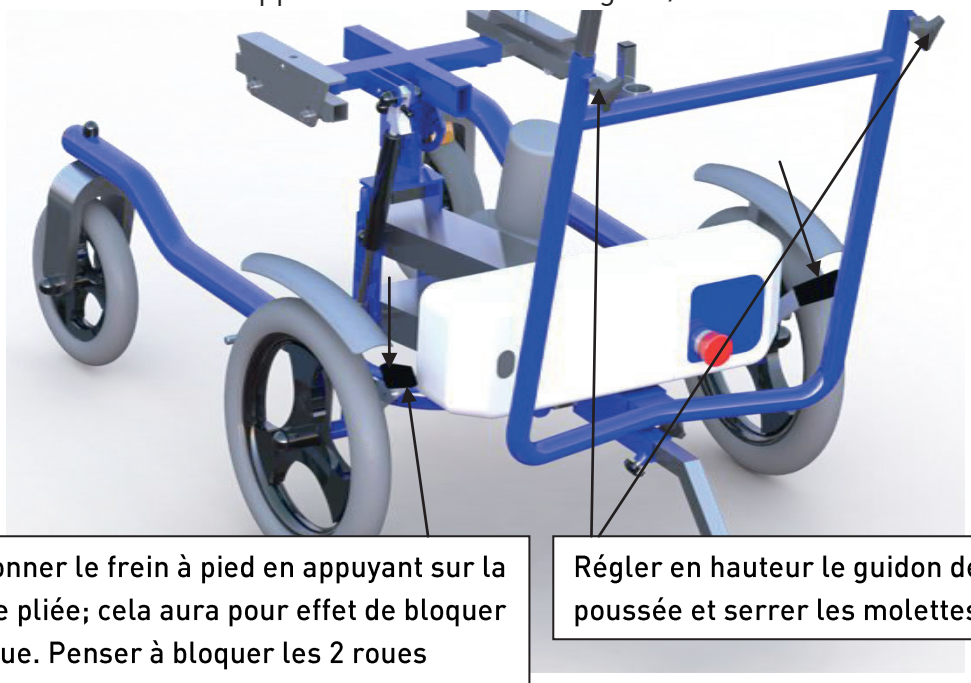

Actionner le frein à pied en appuyant sur la pièce pliée; cela aura pour effet de bloquer la roue. Penser à bloquer les 2 roues arrières en position parking. Remonter la pièce pliée pour débloquer les roues.

Régler en hauteur le guidon de poussée et serrer les molettes.

POSITIONNEMENT DU PLATEAU D'ASSISE

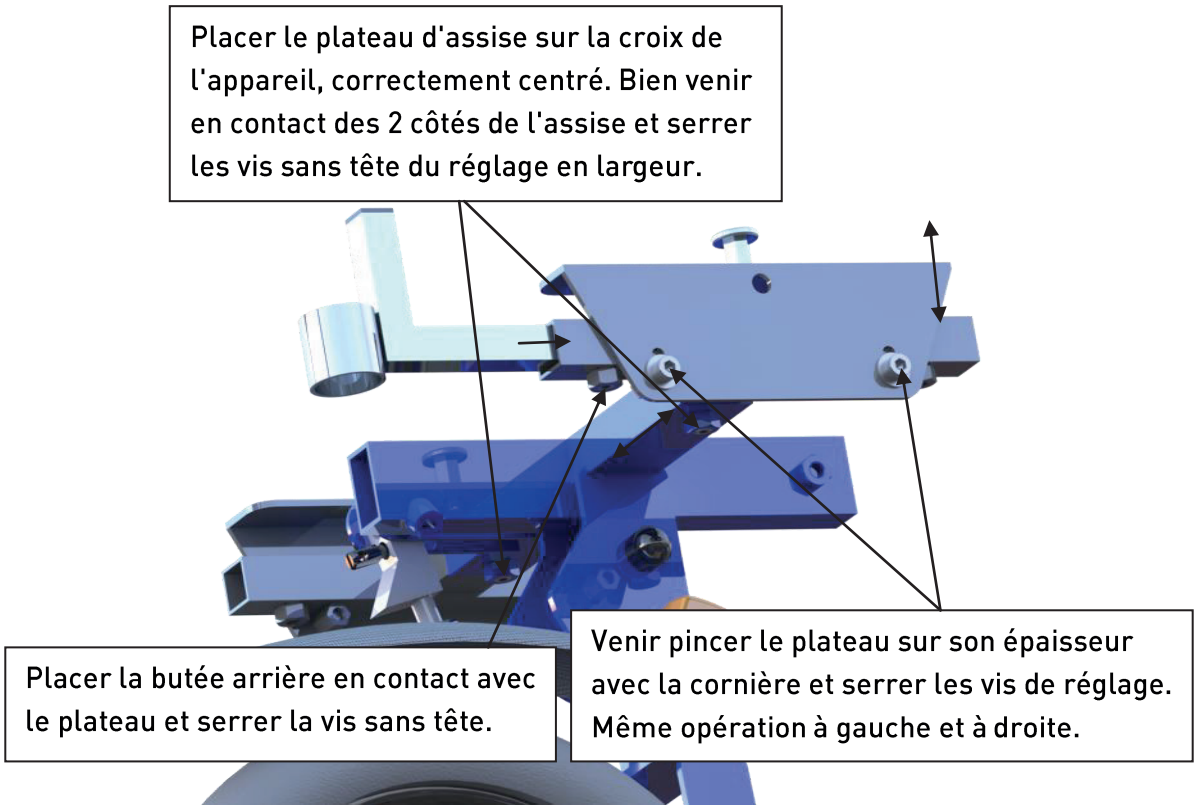

INDEXAGE DU PLATEAU

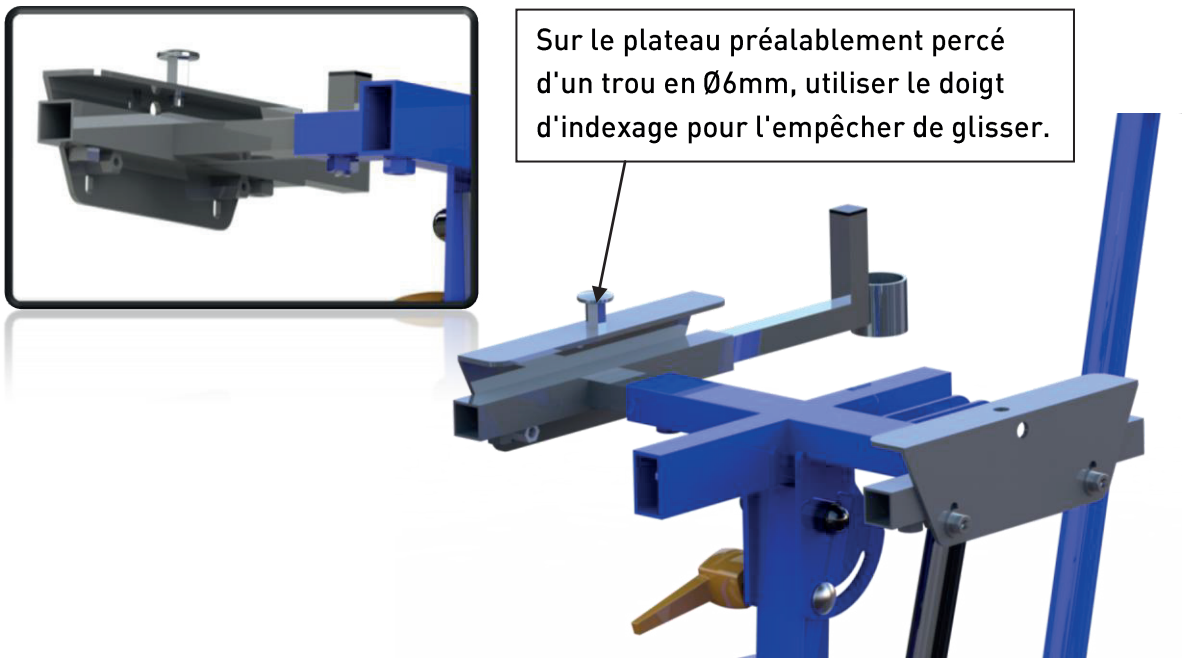

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PLATEAU

⚠ **Attention :** La montée et la descente du plateau se fait par vérin électrique. **Immobilisez l'appareil grâce aux freins intégrés aux roulettes avant toute manipulation.** Les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié. Utiliser le bouton d'arrêt d'urgence (bouton rouge) présent sur la batterie pour libérer le vérin en cas de problème.

Veiller à respecter les préconisations détaillées dans la notice d'utilisation de la batterie fournie avec l'appareil. Entre autre, pour une utilisation durable de la batterie, il est demandé de ne pas effectuer de charge partielle; quand une charge est entamée, attendre que la batterie soit pleine avant de débrancher le câble d'alimentation.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE:

Garder le bouton de **gauche** appuyé pour "ouvrir" le vérin (**monter** le plateau d'assise). Le relâcher à la position souhaitée.

Garder le bouton de **droite** appuyé pour "fermer" le vérin (**descendre** le plateau d'assise). Le relâcher à la position souhaitée.

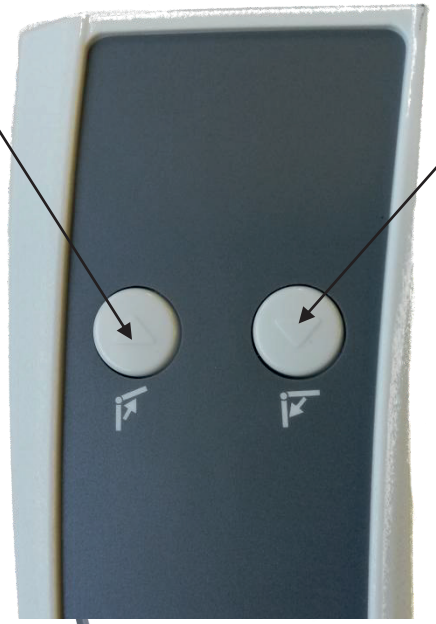

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU PLATEAU

⚠ **Attention :** Immobilisez l'appareil grâce aux freins de parking avant toute manipulation.

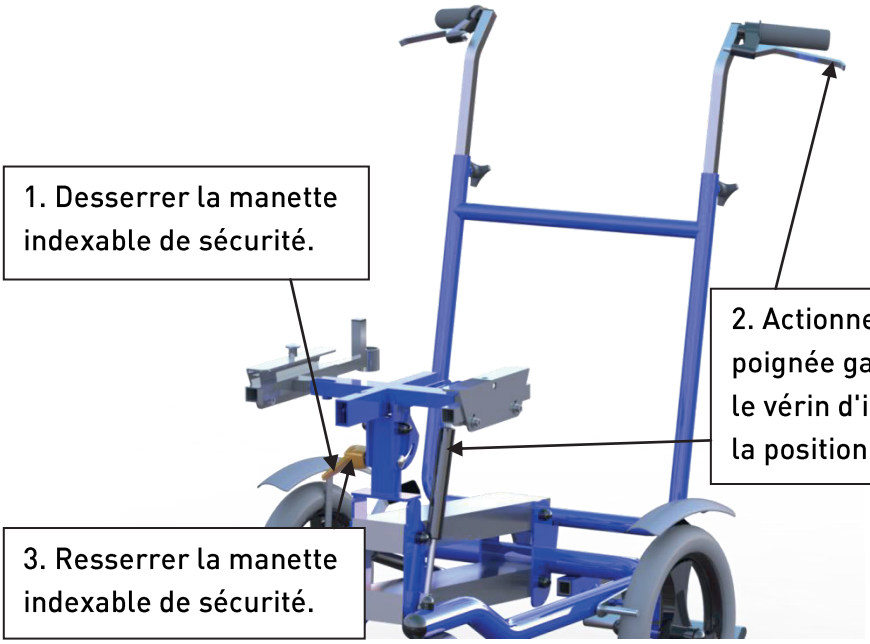

RÉGLAGE DE L'ANTIBASCULE ET GUIDON DÉMONTABLE

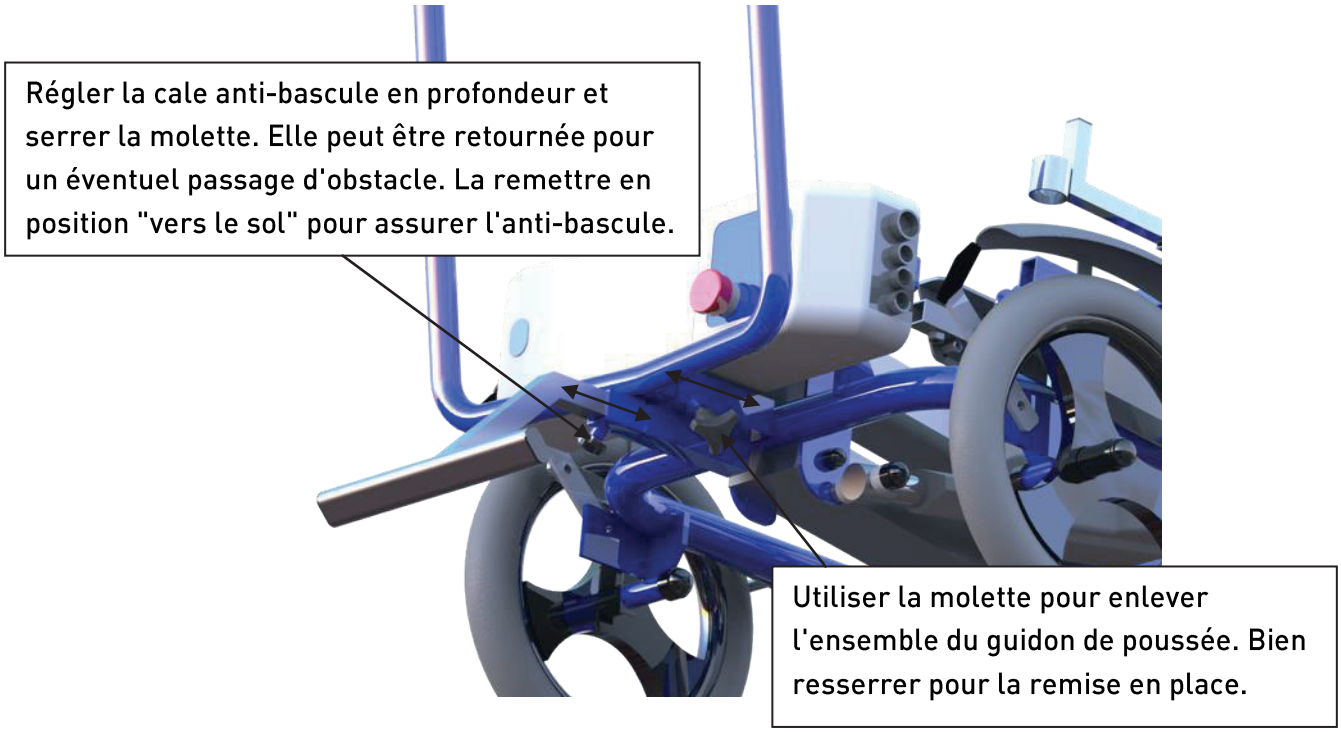

ADJONCTIONS

SUPPORT TABLETTE

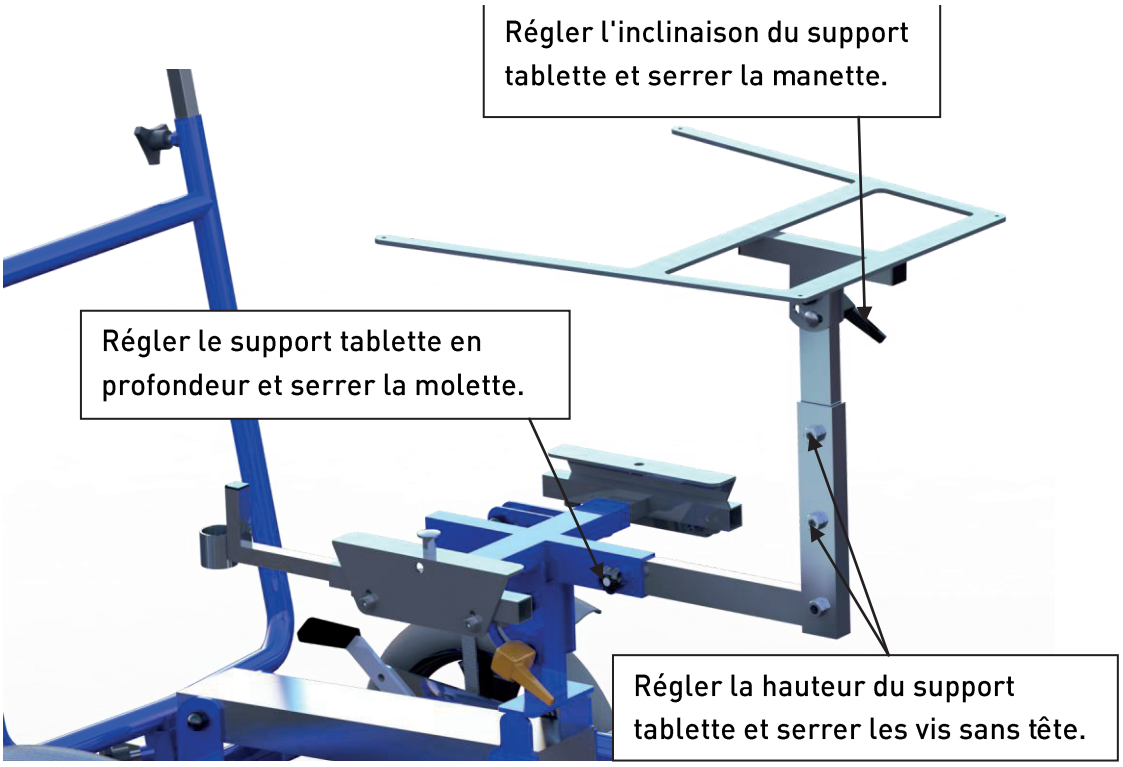

REPOSE-PIEDS

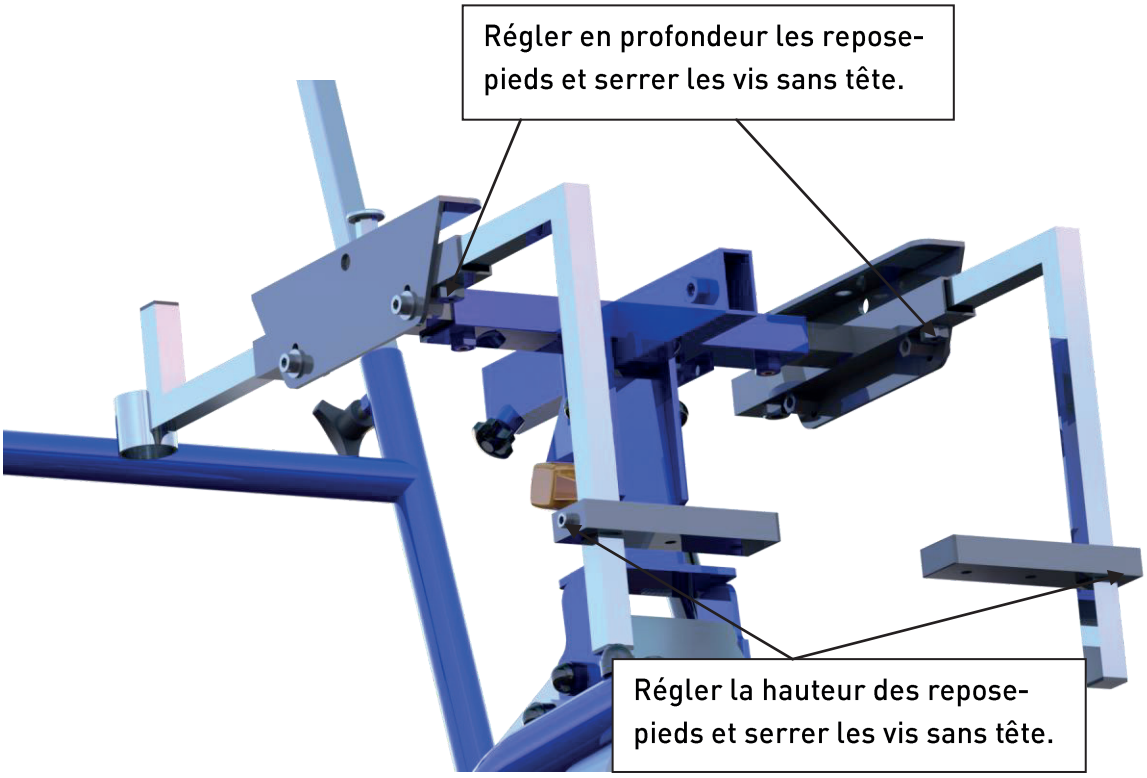

ENTRETIEN / STOCKAGE /MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrippant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.

IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont – 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 – Fax : 04 67 95 06 94 – Mail : administration@recfrance.com
Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document : *NU_Wally_071022-V3*

N° de lot : Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement

MENTIONS LÉGALES

La conception générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire et tout autre élément composant le produit sont la propriété exclusive de RECFRANCE et/ou de ses fournisseurs.
Visuels non contractuels.
Tout incident grave survenu avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi.

DATE D'ACHAT : / /

CACHET DU REVENDEUR :

CE

NOTES

136 ancienne route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél. : 04.67.95.04.50
Fax : 04.67.95.06.94